

先生各位

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
このたび下記検査項目につきまして試薬変更のご案内をさせていただきます。
誠に勝手ではございますが、何卒宜しくご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

● 変更実施日 2023年4月1日（土）受付分より

● 対象項目


案内書掲載頁	項目コード	項目名	変更箇所	変更後	現	変更理由
85	3248	抗Sm抗体(抗SmDp抗体)	報告範囲	0.7未満～330.0以上	0.8未満～480.0以上	測定試薬変更のため
103	1224	ムンプスウイルス IgG		1.0未満～128.0以上	0.1～128.0以上	

<備考>

今回の変更に伴う検査方法、容器、基準値、所要日数などの変更はございません。

<抗Sm抗体(抗SmDp抗体)>

偽陽性発生リスクの低減を目的とした改良試薬へ変更させていただきます。なお、この変更に伴い報告範囲を変更させていただきます。

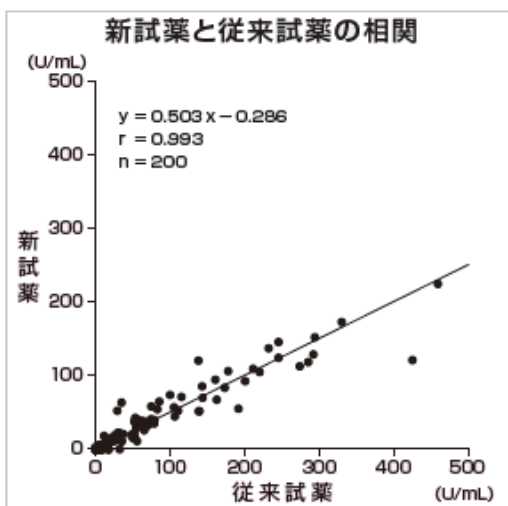

判定一致率表	現法				
	+	±	-	合計	
新法	+	75	0	0	75
	±	7	0	0	7
	-	16	10	92	118
	合計	98	10	92	200



陽性一致率：76.5%
陰性一致率：100.0%
判定一致率：83.5%

委託先資料より

裏面に続く

<ムンプスウイルス IgG>

使用抗原を近年流行している遺伝子型に変えた（遺伝子型A→遺伝子型G）改良試薬に変更させていただきます。
 なお、この変更に伴い報告範囲を変更させていただきます。

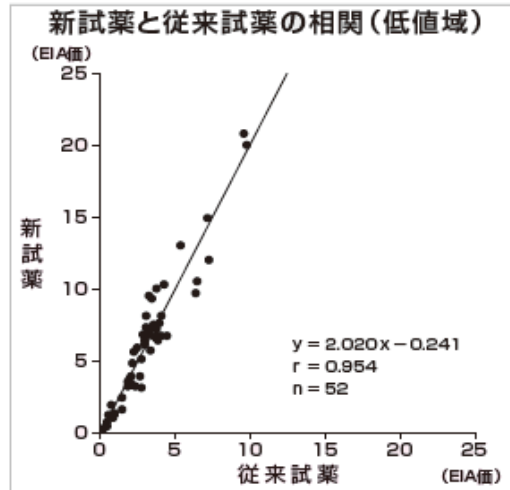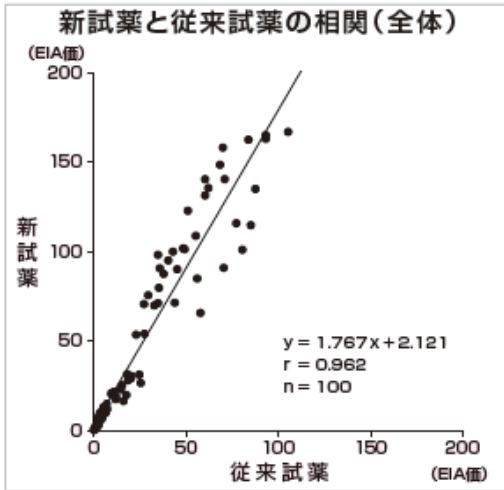

判定 一致率表		現法			合計
		+	±	-	
新法	+	60	21	0	81
	±	0	6	3	9
	-	0	0	10	10
	合計	60	27	13	100

陽性一致率：100.0%
 陰性一致率：76.9%
 判定一致率：76.0%

委託先資料より